

# HY108C 型户外声级计

## 使 用 说 明 书

### 1 主要用途及适用范围

HY108C 型户外声级计是一款数字化声级计仪器，其性能符合国家标准 GB/T 3785.1—2023《电声学 声级计 第 1 部分：规范》和国际标准 IEC 61672-1:2013 对 2 级 Y 类声级计的要求。HY108C 型户外声级计是一种设计用于户外噪声测量的系统，该声级计测量范围宽，功能强，稳定性好，带有防风、防雨、防尘、防鸟刺装置。应用广泛，如适用于城市环境噪声自动监测、噪声污染源（如施工场地、厂界、道路车辆等）在线监测，噪声数据自动采集、传输，它具有全天候监测、无需人值守等特点。

HY108C 型户外声级计采用预极化背极驻极体电容传声器、先进的数字检波技术，具有动态范围宽、性能稳定、无需量程转换、操作简便等优点。量程范围内均具有 0.1 dB 的分辩力，并可完全消除读数误差。声级计采用外接电源（也可接电池）供电，结构设计小巧坚固，特别适用于现场使用和随身携带。

HY108C 型户外声级计具有 A 频率计权，F 时间计权和 S 时间计权，还具有自动校准功能，能测量噪声时间计权压级、最大时间计权声级。

HY108C 型户外声级计为满足不同用户的需要，接口和通讯协议有所不同，特在型号加以配置号来区别，见表 1，用户可通过仪器背后标牌来区别。

表 1 HY108C 型户外声级计的配置表

型号及配置号	接口		通讯协议	
	RS232	RS485	单字符	Modbus
HY108C	√		√	
HY108C-1		√	√	
HY108C-2	√			√
HY108C-3		√		√

注：打“√”表示具有该功能，同时可根据用户的需要，增加户外自校装置（静电激励）。

## 2 主要规格及技术参数

### a) 性能等级

GB/T 3785.1—2023 / IEC 61672-1:2013 规定的 2 级。

### b) 电磁场辐射及抗扰度分类

GB/T 3785.1—2023 / IEC 61672-1:2013 规定的 Y 类。

### c) 频率计权

A 计权。

### d) 时间计权

- F (快响应);
- S (慢响应)。

### e) 频率范围

20 Hz~12.5 kHz。

### f) 采样频率

48kHz

### g) 标称工作模式

配带户外防风防雨罩 (具有防风、防雨、防尘、防鸟停功能)。

### h) 参考环境条件

声级计在以下环境条件下符合技术要求:

- 空气温度: 23 °C;
- 相对湿度: 50 %;
- 静压: 101.325 kPa;
- 周围无强烈的机械振动、冲击、强电磁场和腐蚀性气体存在。

### i) 工作环境条件

- 空气温度: -10°C~50°C。
- 相对湿度: 25%~90%;
- 静压: 65 kPa~108kPa。

### j) 传声器类型

HY205 型预极化 (背极驻极体) 电容式 2 级工程测量传声器 (配防风防雨

罩), 自由场型频率响应, 标称直径 12.7 mm, 标称声压灵敏度为 40 mV/Pa (标称声压灵敏度级为-28 dB, 基准为 1 V), 传声器极头电容量约 15 pF。

传声器的参考点为振膜的几何中心。

HY205 型测量传声器的典型的频率响应见图 1。

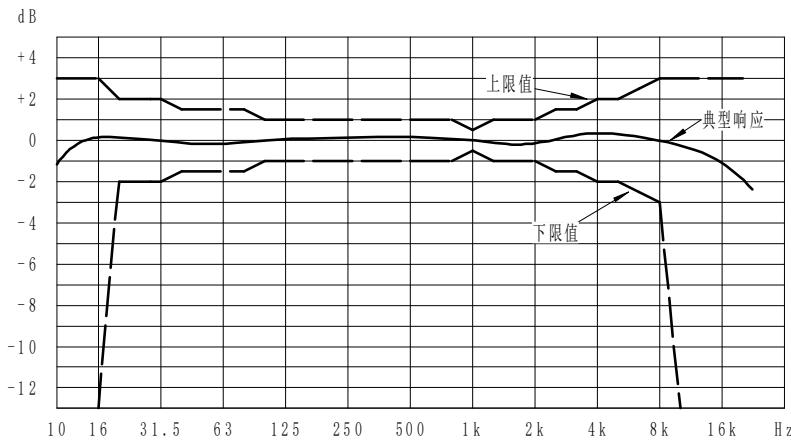


图 1 测量传声器的典型频率响应

k) 显示器

2.2 英寸 (128×64) 点阵式液晶显示器 (LCD), 分辩力为 0.1 dB, 数据更新时间为 1 s。具有过载、欠量限、电池电压低落等告警标志。

l) 1 kHz 频率上的测量范围

30 dB ~ 130 dB。

m) 指向性

在 1 kHz、2 kHz、4 kHz 和 8 kHz 的指向性见图 2。

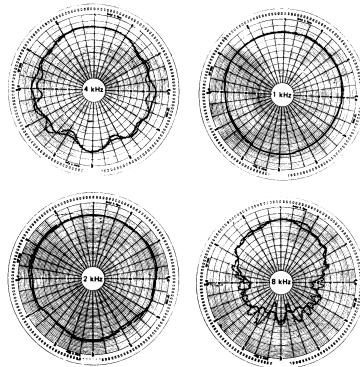


图 2 声级计在不同频率下的指向特性

n) 电源

- 电源接通自动开机，断电自动关机。
- 可连接USB 端口外接电源供电（标配）。
- 可外接12V电源（选配）。
- 也可选用2节R6P型高功率电池或LR6型碱电池供电。

**注意：订货时一定要说明电源的种类。**

o) 声校准器校准

- 校准频率：1 kHz。
- 校准声级：94 dB，在环境噪声较大的场所也可使用 114dB 来校准。
- HY205 传声器自声场修正：0.2dB。

p) 仪器功率

不大于 1W。

q) 使用风罩的影响

在重要的频率范围内不大于 0.5 dB。

r) 参考方向

沿传声器主轴方向入射（0°入射）。

s) 参考声压级

94 dB，基准声压为 20  $\mu$ Pa。

t) 预热时间

60 s。

u) **自生噪声级**

- 在参考环境条件下的自生噪声级不大于 25 dB (A 计权);
- 当声级计的电输入端通过 15 pF 的电容短路时, 其自生噪声级的期望值不大于以上值。

v) **温度的影响**

在 0°C~40°C 的工作温度范围内的任何温度上的指示声级与参考温度上的指示声级的差值不超过±1.0 dB。

w) **湿度的影响**

当相对湿度从 25% 变化到 90% 时, 指示声级与参考相对湿度时的指示声级的差值不超过±1.0 dB。

x) **可能引起声级计永久性损坏的温度、湿度极限值**

- 温度: -20°C 和 +60°C;
- 相对湿度: 95%。

y) **声压响应与自由场响应的调整数据**

通过声校准器产生的声压响应或用静电激励器产生的模拟声压响应, 可通过表 2 的调整数据得到等效的自由场响应。

表 2 自由场响应调整数据

频率 / kHz	自由场增量 / dB	频率 / kHz	自由场增量 / dB
1	0.2	6.3	2.2
1.25	0.3	8	3.4
1.6	0.4	10	5.0
2	0.5	12.5	6.2
2.5	0.7	16	7.6
3.15	0.9	18	8.4
4	1.3	20	9.0
5	1.8	—	—

z) 供试验用取代传声器的电阻抗（供试验用）

15 pF 串联  $10\Omega$ 。

aa) 可施加于传声器上的最高声压级

146 dB。

bb) 可施加于电输入端的最大峰峰值电压

15 V。

cc) 数字输出

输出接头为DB9型公头（针式），调制速率（波特率）为9 600 Bd。

dd) 模拟输出

输出插孔为 3.5mm 双声道耳机插孔。

直流输出：输出电压约为  $15\text{mV}/\text{dB}$ ，范围为  $450\text{mV} \sim 1950\text{mV}$ 。

交流输出：输出与被测信号成线性关系，最大交流输出电压的方均根值不超过 2V。

ee) 外形尺寸（长×宽×厚）

180mm×68mm×31 mm。

ff) 支撑杆尺寸

材料不锈钢，尺寸为  $\Phi 25 \times 320\text{mm}$ ，固定螺母为 M22×1，带保护罩总长为 450mm。另带静电激励远程校准，则带保护罩总长为 500mm。

gg) 支撑杆安装尺寸

推荐安装孔直径为  $\Phi 22.5\text{mm} \sim \Phi 24\text{mm}$ ，安装板厚度为  $1\text{mm} \sim 3\text{mm}$ 。

### 3 使用和操作

#### 3.1 外形

仪器的外形见图 3。因为每台仪器的支撑杆上的传声器的灵敏度均不相同，且出厂时均使用声校准器对包括传声器在内的整机进行校准过，所以用户通常不能将支撑杆（含传声器和延伸电缆）随意互换使用，即需要保证支撑杆和声级计是一一对应的，否则可能导致测量出现较大误差。如果用户手头有声校准

器，在特殊情况下，也可以互换支撑杆，但互换之后必须进行声校准操作，详见 3.4。



不带自校装置      带静电激励自校装置

图 3 外形图

### 3.2 仪器的输出接口

在声级计下端的侧面，打开端口盖板，见到仪器的输出接口，见图 4。图 4：3.5 mm 双声道耳机插孔为交流/直流输出口，DB9 插头为 RS232 或 RS485 平行接口输出口，Mini-USB-B 型插座为外接电源端口（5V），或间距 3.5mm 的 2 脚插座（12V），注意区分正负极



注：带自校装置（静电激励）仪器，接口多一个调静电装置大小的电位器口。

图 4 输出接口图

### 3.3 按键

按键的示意图见图 5。



图 5 按键示意图

#### 按键功能说明：

校准键：按校准键，进入校准界面。

复位键：用于最大值复位。

电源键：该仪器通电开机，断电关机，按键不能开机或关机，另在“校准、  
阈值”设置界面，作为“返回”键使用。

$L_p$  键：噪声时间计权声级。

$L_{max}$  键：噪声时间计权声级最大值。

F 键 : 选择 F 时间计权。

S 键 : 选择 S 时间计权。

### 3.4 校准

可利用各种型号的声校准器对 HY108C 型户外声级计进行声学校准, 这种校准是对包括传声器在内的整机的校准。建议采用 HY603 型型双声级声校准器或其它包括有 94 dB、1 kHz 输出信号的声校准器。

采用 HY603 时的校准程序如下:

- a) 将延伸电缆插入仪器端口, 连接好仪器, 逆时针旋转取下防风防雨罩。
  - b) 接通电源 (装电池或通过 USB 端口外接电源), 自动开机。
  - c) 预热 60 s。
  - d) 将声校准器紧密地耦合在声级计的传声器上, 启动声校准器。
  - e) 按“校准”键进入校准界面, 见图 7。
  - f) 根据校准器的校准声级及工作频率, 修改“校准级”值及“自由场修正”值, 按键使用见 3.4, 修改完毕后, 按“校准”键, 开始校准, 显示屏下正下方会显示校准剩余时间。
  - g) 校准完后, “LAF”显示校准后的声级, 同时显示屏正下方会显示“成功”。如出现“太高”、“太低”或“不稳”, 都表示校准不成功, 则应检查声校准器或校准级设置是否不对, 确认后再按“校准”键进行下一次校准。
  - h) 校准结束后, 按“返回”键退出校准界面, 关闭声校准器, 并取下声校准器。
  - i) 顺时针将防风防雨罩装上。
- 此时声级计已经校准好。

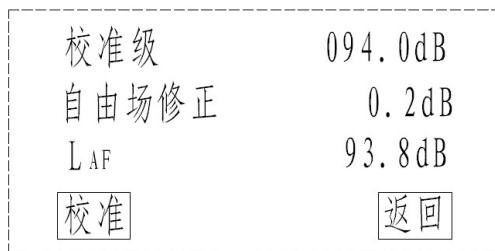


图 7 校准界面

#### 注意：

- 1、该仪器只能使用 1kHz 频率的声校准器进行校准。
- 2、校准时，要确保声校准器与传声器紧密耦合。
- 3、校准时，背景噪声至少应比所用的声校准器的输出声压级低 20 dB，否则应按声校准器使用说明书的要求进行修正。
- 4、在背景噪声较高的场合校准声级计时，应使用 HY603 的 114 dB 档。尽管 HY108C 型户外声级计具有很高的稳定性，仅要求周期性地进行调整，仍然建议在每次测量前后都进行一次校准检查。

#### 3.5 测量

一般噪声测量的步骤如下：

- a) 通电开机，用声校准器检查声级计的校准情况。
- b) 选择时间计权 “F” 或 “S”。
- c) 再选择测量项 “Lp” 或 “Lmax”。
- d) 待声级计预热后，即可从显示屏上读取测量结果，见图 8。
- e) 测量完毕后，建议再用声校准器检查声级计的灵敏度，以确保测量数据的准确可靠。
- f) 关机。

#### 注意：

测量声压级最大值，按“复位”键即可进行下一次测量。

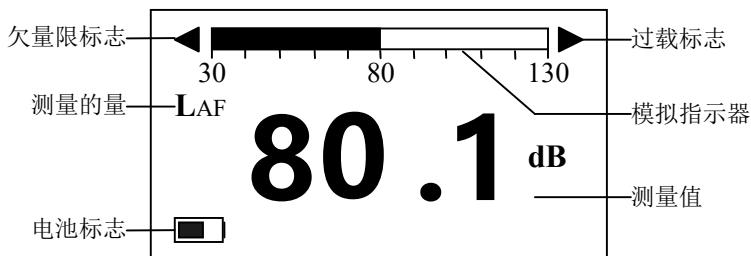


图 8 测量界面

### 3.6 模拟输出及接线

HY108C 型户外声级计设有交流电压和直流电压输出信号，为减小体积，交、直流输出共用一个 3.5mm 双声道插孔。外接仪器（如数字多用表、记录仪等）可通过随机所附的 3.5mm 插头与声级计的输出相连。用户在使用时应根据所需电压的类型正确地连接输出线，见图 9。

直流输出：输出电压约为 15mV/dB，范围为 450mV~1950mV。

交流输出：输出与被测信号成线性关系，最大交流输出电压的方均根值不超过 2V。

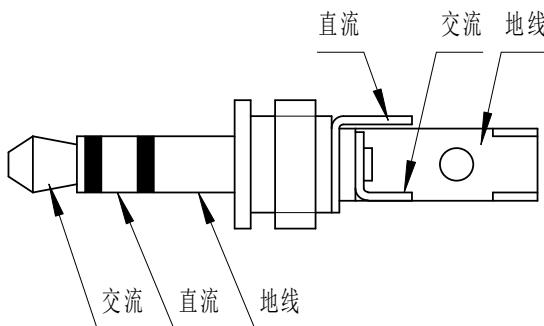


图 9 模拟输出插头的连接

### 3.7 与外设通讯

HY108C 型户外声级计具有 RS232 接口或 RS485 接口, 可用于与外设连接, 向外输出数据。

两种接口可选“单字符”通讯协议或“Modbus”通讯协议。“单字符”通讯协议为本公司自定义的通讯协议, “Modbus”通讯协议则与市面上通用的 Modbus 协议类似。

### 3.7.1 接线方法

输出接头为 DB9 型公头 (针式), 具体引脚功能见下图。RX (接收) 和 TX (发送) 是相对声级计这边而言, 实际接线时, 外设的 TX 接声级计的 RX, 外设的 RX 接声级计的 TX。以下是声级计平放后从声级计的底部所看到的输出接头 (针式) 的视图。为避免接线错误, 请用户仔细对照下图所示功能和数字标号, 有条件的可用万用表测量接线导通情况。如接线大致无误, 但仍存在无法通讯的情况, 请调换 RX 和 TX, 或调换 A 和 B。



图 10 DB9 引脚功能图 (仪器底部视图)

### 3.7.2 单字符通讯协议

#### 3.7.2.1 通讯参数

- a) 调制速率 (波特率)  
9 600 Bd。如用户要求, 可设置为其他值。
- b) 帧格式  
1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无奇偶校验。

#### 3.7.2.2 通讯命令和代码

HY108C 型户外声级计与计算机通讯的命令和代码及其含义见表 3。

表 3 命令和代码及其含义

序号	命 令	代 码	含 义
1	瞬时声级	L(4CH)	声级计收到“L”命令后，开始发送瞬时声压级数据。
2	连续发送/停止数据	C(43H)	声级计收到“C”命令后，开始连续发送瞬时声压级数据,再发送“C 或 R”命令，停止发送连续数据。
3	最大值	M(4DH)	声级计收到“M”命令后，开始发送单次声压级最大值。
4	仪器状态	S(53H)	声级计收到该命令后，向计算机发送仪器的状态。
5	复位	R(52H)	声级计收到该命令后立即复位声级计，即重新计算最大值数据，或停止数据连续发送，然后向计算机发送 R 以表示收到此命令。
6	打开静电激励	K(4BH)	声级计收到“K”命令后，静电激励打开，发出模拟标准声信号。
7	关闭静电激励	G(47H)	声级计收到“G”命令后，静电激励关闭，关闭模拟标准声信号
8	校准	J(4AH)	声级计收到该命令后立即校准声级计，5s 后校准结束，校准成功后校到 93.8dB。

### 3.7.2.3 单一数据的格式

声级计接收到 L、M、N 和 P 命令后发送单一的数据，该数据由 9 个字节组成，其格式如下：

起始字节(01H)+声级数据(5 字节)+校验和(2 字节)+结束字节(FFH)

其中：

——声级数据用其对应的 ASCII 码表示，例如“114.5”对应的十六进制形式的 ASCII 码为“31 31 34 2E 35”，“094.2”（小于 100.0dB 其百位显示 0）对应的十六进制形式的 ASCII 码为“30 39 34 2E 32”。

——校验和为 5 个字节的声级数据的累加和，高字节在前，低字节在后。

示例：

01 30 39 34 2E 32 00 FD FF：其中声级数据为“30 39 34 2E 32”，它

为数字“094.2”的十六进制形式的 ASCII 码，即 94.2 dB；“00 FD”为校验和， $30H+39H+34H+2EH+32H=00FDH$ 。

### 3.7.2.4 状态数据的格式

声级计接收到 S 命令后发送仪器的状态数据，该数据由 6 个字节组成，其格式如下：

起始字节(01H)+状态数据(2 字节)+校验和(2 字节)+结束字节(FFH)

其中：

——状态数据：A~G 位表示声级计的状态，各位意义见 6.2.2。

——校验和为 2 个状态字节的累加和，高字节在前，低字节在后。

示例：

01 51 00 00 51 FF 表示仪器状态为：普通模式，欠压，C 计权，F 时  
间计权，次灵敏档；“00 51”为校准和， $51H+00H=0051H$ 。

状态字节中各位的意义如下所示：

MS	6	5	4	3	2	1	LS
B							B
A	B	C	C	D	D	E	E

MS	6	5	4	3	2	1	LS
B							B
F	G	G	G	G	G	G	G

其中：

——A 位保留，默认为 0。

——B 位表示电池状态：

- 0：正常；
- 1：欠压。

——CC 位表示频率计权：

- 00：A；
- 01：C；
- 10：Z；
- 11：Flat。

——DD 位表示时间计权:

- 00: F;
- 01: S;
- 10: I。

——EE 位表示级量程:

- 00: 最灵敏挡;
- 01: 次灵敏挡, 如果声级计为全量程, 即不分挡, 则默认为此挡;
- 10: 较不灵敏挡;
- 11: 最不灵敏挡。

——F 位表示测量模式:

- 0: 普通模式;
- 1: 积分测量模式。

——G 位暂未定义, 默认全部为 0。

### 3.7.2.5 连续数据的格式

声级计接收到 C 命令后连续地发送测量数据, 该数据由 10 个字节组成, 与单一数据的格式相比, 多了 1 个表示声级状态的字节, 其格式如下:

起始字节(01H)+声级数据(5 字节)+状态(1 字节)+校验和(2 字节)+结束字节(FFH)

其中:

——声级数据用 ASCII 码表示, 其格式与单一数据格式相同。

——状态: A~C 位表示测量数据的状态, 各位意义见 6.4.2。

——校验和为 5 个数据字节和 1 个状态字节的累加和, 高字节在前, 低字节在后。

示例:

01 31 30 34 2E 37 A0 01 9A FF 表示瞬时声级为 104.7 dB, 过载, 超阈

值：“01 9A”为校准和， $31H+30H+34H+2EH+37H+A0H=019AH$ 。

状态字节中各位的意义如下所示：

MSB	6	5	4	3	2	1	LSB
A	A	B	C	C	C	C	C

其中：

——AA 位表示信号级的状态：

- 00：正常；
- 01：欠量限；
- 10：过载。

——B 位表示是否超阈值：

- 0：正常；
- 1：超阈值。

——C 位暂未定义， 默认全部为 0。

### 3.7.3 Modbus 通讯协议

#### 3.7.3.1 通讯参数

##### a) 调制速率（波特率）

9 600 Bd。如用户要求，可设置为其他值。

##### b) 帧格式

1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位，无奇偶校验。

##### c) 功能码

0x03：读取测量数据；0x04：读取控制参数；0x06：修改控制参数。

以下数据均为十六进制格式，省掉前面的 0x。

##### d) 校验码

采用 CRC16 校验码，低字节在前，高字节在后。

##### e) 设备地址

地址范围 1~255。0 为广播地址，当 485 总线上只有单台设备时方可使用。

### 3.7.3.2 读取测量数据

如需一次性获取 2 个参数 ( $L_p$  和  $L_{max}$ )，可发送以下指令。

说明	地址	功能码	起始地址	参数个数	校验码
发送	01	03	00 00	00 02	C4 0B

接收的响应数据如下。数据均放大 10 倍，例如  $L_p$  为 “02 DC”，对应的十进制数为 732，实际值为 73.2dB。

说明	地址	功能码	长度	$L_p$	$L_{max}$	校验码
响应	01	03	04	02 DC	03 BE	BA F1

如只对某一个参数感兴趣，可使用以下读取单一测量数据的指令：

#### 瞬时值 $L_p$

发送 01 03 00 00 00 01 84 0A

响应 01 03 02 02 DC B8 BD

#### 最大值 $L_{max}$

发送 01 03 00 01 00 01 D5 CA

响应 01 03 02 03 BE 38 C4

### 3.7.3.3 读取控制参数

发送以下指令可获得“设备地址”。地址 00 为广播地址，当 485 总线上只有单台设备时可借此查询声级计的设备地址。

说明	地址	功能码	起始地址	参数个数	校验码
发送	00	04	00 00	00 01	30 1B

接收的响应数据如下。

说明	地址	功能码	数据长度	控制参数	校验码
发送	00	04	02	00 01	45 30

其余控制参数与之类似，只是“起始地址”不同。“校准状态”对应地址 01，“频率计权”对应地址 02，“时间计权”对应地址 03，“阈值”对应地址 0A，“报警”对应地址 0B。

#### a) 校准状态

发送 01 04 00 01 00 01 60 0A

响应 01 04 02 00 00 B9 30

校准状态分别为：0=校准成功，1=校准中，2=声级太高，3=声级太低，4=声级不稳。

#### b) 时间计权

发送 01 04 00 03 00 01 C1 CA

响应 01 04 02 00 00 B9 30 或 01 04 02 00 01 78 F0

时间计权分别为：0=F 计权，1=S 计权。

### 3.7.3.4 修改控制参数

功能码 06 一次只能修改一个控制参数。接收到的响应与发送的指令相同。

发送以下指令可设置“设备地址”。以下示例将地址从 01 修改为 02。“控制参数”中所表示的值即是“设备地址”。

**注意：**从“地址”开始至“校验码”之前的数据，如果有一个不同，则校验码会相应变化，请用户务必计算出正确的校验码。

说明	地址	功能码	起始地址	控制参数	校验码
发送/响应	01	06	00 00	00 02	08 0B

其余控制参数与之类似，只是起始地址不同。“校准”对应地址 01，“时间计权”对应地址 03，“复位”对应地址 04。

#### a) 校准

01 06 00 01 00 01 19 CA

校准过程大概持续 6 秒，可在 6 秒后发送查询校准状态指令。

b) 时间计权

01 06 00 03 00 00 79 CA F

01 06 00 03 00 01 B8 0A S

以下 2 个指令分别设置时间计权为 F 或 S。

c) 复位

01 06 00 04 00 01 09 CB

发送复位指令后  $L_{max}$  将复位，即重新开始计算，或停止数据连续发送。

注意：修改时间计权后，声级计内部也会执行“复位”操作。

d) 打开静电激励

01 06 00 05 00 01 58 0B

说明：静电打开后，工作电流增大，记得校准完毕后，要关闭静电激励。

e) 关闭静电激励

01 06 00 05 00 00 99 CB

f) 静电状态查询

发送 01 04 00 05 00 01 21 CB

响应 01 04 02 00 00 B9 30 (表示关闭)

响应 01 04 02 00 01 78 F0 (表示开启)

说明：对于具有静电激励功能的仪器，打开静电激励，仪器应显示  $90.0 \pm 0.2 \text{dB}$ ，如不在此范围内，请调节仪器下部接口处电位器。

#### 4 故障分析与排除

本章包括有助于解决您可能会遇到的一些简单的操作方面的问题的方法，同时给出了一些常见故障的现象、可能的原因和排除方法。如果不能解决您的问题或是遇到了仪器装配或工作中的问题，请向湖南声仪或您在当地的代理商寻求进一步的援助。

HY108C 型户外声级计在使用中常见的故障及排除方法见表 4。

表 4 常见的故障及排除方法

故障现象	原因分析	排除方法	备注
仪器不显示	未装电池	装上新电池	
	电池没电或电压太低	装上新电池	
	电池安装极性不正确	取出电池, 按正确的极性安装	
	电池与电池盒接触不良	确保电池与电池盒接触良好; 如仪器曾发生过电池泄漏事故, 则需要清除接触点处的锈蚀; 或向湖南声仪或当地代理求助	
	外接电源电压不符合要求	请查看第 2 章 m)项	
校准失败	声校准器未开机	声校准器开机后再试	
	传声器松动或未安装	检查传声器是否拧紧并安装正确	
	传声器可能已损坏	向湖南声仪或当地代理求助	
测量时, 显示不正常	传声器可能已损坏	向湖南声仪或当地代理求助	
	声级计内部电路已损坏	向湖南声仪或当地代理求助	
	延伸电缆未插	将延伸电缆插入仪器	
显示电池电压空格并闪烁	电池电压低于仪器正常工作电压	更换电池	
输出不正常	输出插头接触不良	确保输出插头与插座可靠连接	
	输出插头接线不正确	按说明书要求正确连接输出插头	
	输出连接线已损坏	向湖南声仪或当地代理求助	
	仪器内部电路已损坏	向湖南声仪或当地代理求助	

## 5 产品的成套性

### 5.1 主要附件及其应用

为进一步改善声级计的性能以及便于检查、调整，HY108C 带有众多的附件，各主要附件的作用如下：

#### (1) 防风防雨罩

该保护罩主要用于户外测量，内部具有防风、防雨、防鸟刺功能，用声校准器校准时，需取下防风防雨罩。

#### (2) 输出插头

用以将声级计的模拟输出信号与外部仪器连接。

#### (3) 串口通讯线

用于将声级计的数字输出信号与计算机通讯。

### 5.2 需另订货的配套件及其用途

#### (1) 声校准器

声校准器用于对声级计的整机校准。HY603 型声校准器是一款 2 级声校准器，可产生频率为 1000 Hz、声压级为 94 dB 和 114 dB 的两个标准的等效声压，主要用于 2 级声级计的校准。声校准器稳定可靠，是采用电池供电的便携式基准声源。

#### (2) 输入适配器、同轴插头及连接电缆

HY7314 型适配器、HY7311 型 14 mm 标准同轴插头和 HY7010 型连接电缆供采用电气信号调整、校准时，连接声级计和信号源用。

#### (3) 携带箱

用高强度 ABS 工程塑料成型的手提箱，内部装有泡沫防震衬垫，它用于将声级计、声校准器、小号三角架及其它附件装为一箱，对于野外测量极为方便。（注意：声级计不宜长时间地存放在携带箱中）。

## 6 产品成套一览表

HY108C 型户外声级计的产品成套一览表见表 5。

注：每台声级计所带的附件以发货清单为准。

表 5 产品成套一览表

类 别	名 称	型号规格	单 位	数 量	备 注
主 机	声级计		台	1	
标 准 附 件	电容传声器	HY205	只	1	随机
	支撑杆		根	1	32cm 长, 不锈钢
	防风防雨罩		只	1	防风、防雨、防鸟刺
	信号延伸电缆线		根	1	3m
	DB9 连接线(母对母, 2、3 交叉)				1m (仅 RS232 接口才具有)
	电源适配器	USB 充电器头	个	1	输出 DC5V 2A
	电源线	Mini USB	根	1	1.5m(仅 Mini USB 接口才有)
	纸包装盒		个	1	
需 另 订 配 件	适配器	HY7314	只		
	同轴插头	HY7311	只		
	声校准器	HY603	只		
	三角架	大、中、小	个		
	携带箱	HY7711	个		
	电源适配器	USB 充电器头	个		输出 DC5V
文 件	使用说明书		份	1	
	产品合格证		份	1	

## 7 声级计的维护

### 7.1 一般注意事项

为防止由于使用和操作不当而致使声级计损坏, 特提请注意以下事项:

- (1) 使用完毕后立即将电池取出, 以免电池漏液而损坏仪器。
- (2) 声级计应存放于干燥、温暖的场所, 如有可能, 最好置于干燥皿中。

(3) 在装卸传声器、延伸电缆、电池或外接电源时，应事先将电源开关置于“关”。

(4) 不要随意取下传声器的保护罩，以免损坏膜片。当发现膜片较脏时，可用脱脂棉蘸以少许三氯乙烯或丙酮轻轻擦拭干净。

(5) 不要用手触摸输入触头，以防由于人体静电而损坏声级计。

(6) 液晶是有机化合物，如果长期暴露于强烈的紫外线辐射下，将会发生光化学反应，因此在使用中应尽量避免光直接照射在显示器上。

(6) 带有户外自校装置的仪器，主机和户外杆都有编号，装配时要一一对应，不能编号不一致。

## 7.2 周期检定

用于安全和环保领域的声级计属于强制检定的计量器具，按照计量法的规定应定期定点由国家计量行政部门授权机构进行周期检定，检定的有效期为一年。用于其它领域的声级计也应定期检定和校准，以确保测量结果的准确可信。

## 8 售后服务

### 8.1 认证认可

湖南声仪测控科技有限公司质量管理体系已通过北京世标认证，符合 GB/T 19001 / ISO 9001 标准要求，注册号：03819Q00195ROM。

HY108C 型户外声级计已获得中华人民共和国计量器具型式批准证书，其标志和编号见图 11。



图 11 计量器具型式批准证书的标志及编号

### 8.2 售后服务

声级计自出厂之日起一年内，如发生非用户使用不当而造成的故障，湖南

声仪公司及其设在全国各地的维修点均可免费给予修理。对超出保修期或人为故障的声级计修理，也仅收取材料费。

HY108C 型户外声级计是一台复杂的仪器，而且重量很轻，因此建议用户不要自行修理。可将有故障的声级计取出电池后，寄往湖南声仪测控科技有限公司销售服务部。

通讯地址：湖南省衡阳市白沙洲工业园区长塘路 6 号

邮政编码：421007

电 话：0734 8484008 0734 8484029

传 真：0734 8484062

网 址：[www.hy-syck.com](http://www.hy-syck.com)

电子邮箱：[1464593406@qq.com](mailto:1464593406@qq.com)

---

2025 年 11 月第 1.6 版